

Otrzymują Wykonawcy  
zainteresowani  
przedmiotowym postępowaniem

**Nasz znak:** ZOZ.XI.5/272/6/1/20

**data:** 11.02.2020 r.

**DOTYCZY:** Zapytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/20/ZP na zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych.

W związku z zapytaniami firm, które zgłosiły swój udział w przetargu nieograniczonym nr 6/20/ZP - zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r; Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje co następuje:

### **TREŚĆ PYTAŃ:**

#### **Firma I**

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści kompresy podwijane z brzegami z obu stron?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opatrunki do mocowania kaniul bez dodatkowej luźnej podkładki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 15, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza inne metody sterylizacji.

Pakiet 15, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym

samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 15, poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 15, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 szt. serwety z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Firma II**

**dot. przedmiotu zamówienia:**

1. **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania watę opatrunkową bawełniano-wiskozową o składzie minimum 50% bawełny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

2. **Pakiet 7.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przylepiec włókninowy z klejem akrylowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

3. **Pakiet 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania opatrunków do mocowania wkłuc w rozmiarze 5,8x8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. **Pakiet 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania opatrunków do mocowania wkłuc bez metki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

5. **Pakiet 11 poz. 14-16.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawice AQL 1,5?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

6. **Pakiet 14 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pokrowiec na ramię C w rozmiarze 183x104cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

7. **Pakiet 14 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania serwetę jałową, z włókniny foliowanej o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

8. **Pakiet 14 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw z serwetą na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) w rozmiarze 150x190cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. **Pakiet 14 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw z 3 warstwowymi serwetami przylepnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie dot. umowy:**

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 6 ust.1a),b),c) słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne, o których jest mowa w § 6 ust. 1a),b),c) były naliczane nie od maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 5 ust. 1 umowy, ale od wartości towaru niedostarczonego w terminie dostawy lub towaru uzupełnionego lub towaru podlegającego wymianie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, o której mowa w § 6 ust.1 d), była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**c.d. pytań**

**dot. przedmiotu zamówienia:**

1. **Pakiet 14 poz. 11.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu zabiegowego do znieczulania o składzie:

- kompres z gazy 17N 8W 7,5x7,5cm – 7 szt.
- serweta włókniny 80x60cm z otworem i przylepcem – 1 szt.
- serweta z włókniny foliowanej 75x75cm – 1 szt.
- kleszczyki plastikowe pean 13cm – 1 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.**

2. **Pakiet 17 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na stół Mayo w kolorze niebieskim z folią o grubości 50µm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. **Pakiet 17 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

serweta z włókniny 3-warstwowej propylenowo-polietylenowo-wiskozowej z elementem elastycznym i otworem 4m, włóknina o chłonności 824% i odporności na przenikanie cieczy 191 cm H <sub>2</sub> O z elementem elastycznym i otworem	1	300x240	OKRĄG	4
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stół Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	4	40x20		

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. **Pakiet 8 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- serweta w rozmiarze 240x150cm z przylepcem z warstwą chłonną wykonana z laminatu polipropylenowo- polietylenowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, chłonności 570%, odporności na przenikanie cieczy 250cm H<sub>2</sub>O, odporności na wypychanie na sucho/mokro 150 kPa w strefie krytycznej oraz odporności na rozerwanie na sucho/mokro 75/80N – 1 szt.
- serweta w rozmiarze 200x170cm z przylepcem z warstwą chłonną wykonana z laminatu polipropylenowo- polietylenowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, chłonności 570%, odporności na przenikanie cieczy 250cm H<sub>2</sub>O, odporności na wypychanie na sucho/mokro 150 kPa w strefie krytycznej oraz odporności na rozerwanie na sucho/mokro 75/80N – 1 szt.
- serweta w rozmiarze 90x75cm z przylepcem z warstwą chłonną wykonana z laminatu polipropylenowo- polietylenowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, chłonności 570%, odporności na przenikanie cieczy 250cm H<sub>2</sub>O, odporności na wypychanie na sucho/mokro 150 kPa w strefie krytycznej oraz odporności na rozerwanie na sucho/mokro 75/80N – 2 szt.
- taśma mocująca przylepna rozm.50cm x 9cm – 1 szt.
- serweta na stół MAYO rozm.145cm x 80cm – 1 szt.
- serweta na stół instrumentalny ,rozm. 190cm x 150cm o gramaturze 84g/m<sup>2</sup>, odporności na wypychanie na sucho/mokro >40 kPa, na zerwanie 110 N/50mm – 1 szt.

- serweta do osuszania rąk z włókniny kompresowej, 40g/m<sup>2</sup>, roz. 20cm x 40cm – 2 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie - blister. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami.

**Odpowiedź:** Jeżeli pytanie dotyczy pakietu 17 poz. 3 to Zamawiający dopuszcza.

### **Firma III**

#### **Pakiet 11, poz. 1-3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych o kształcie uniwersalnym kategorii III, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 11, poz. 14-16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o sile zrywania min. 6, 5 N.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pakiet 13, poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z przedłużonym mankietem o poziomie AQL  $\leq 1,5$ .

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 16, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego opatrunku o rozmiarze 7x9 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

### **Firma IV**

#### **Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1-3:**

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika rękawic zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic diagnostycznych zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 14-16:**

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika rękawic zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic posiadających siłę zrywu przed starzeniem min. 8,15 N, siłę zrywu po starzeniu min. 7,09 N. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4-6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycjach rękawic jałowych (Zamawiający podaje jako jednostkę miary para), czy rękawic niejłowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic niejłowych.

#### **Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic w rozmiarze S czy XL.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ rozmiar S.

#### **Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4-6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic diagnostycznych nitylowych jałowych o długości min. 244 mm, lepszym poziomie AQL = 1.0 oraz sile zrywu przed starzeniem min. 11,75 N. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4-6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic diagnostycznych nitylowych niejalousych o lepszym poziomie AQL = 1.0 oraz sile zrywu przed starzeniem min. 13,21 N. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic o lepszym poziomie AQL = 1.0. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji **jałowego zestawu do chirurgii kończyny górnej** - zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład:

- 1 serweta główna wzmocniona w kształcie "T" o wym. 150/320x270cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm wyposażona w 2 podwójne uchwyty do mocowania drenów (wzmocnienie 50x100cm)
- 1 serweta o wym. 100x150cm
- 1 samoprzylepna taśma mocująca ("rzep") 2,5x25cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji **jałowego zestawu podstawowego** - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 170x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów

oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytania do wzoru umowy:**

1. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 – 6 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do **5 dni roboczych**. **UZASADNIENIE:** Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353<sup>1</sup> KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II **Ca 450/14**).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Wnosimy o modyfikację postanowień dot. kar umownych przewidzianych w projekcie umowy

w ten sposób iż:

- w § 6 ust. 1 lit a) do c) wnosimy o określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto **konkretnej, zamówionej, a niedostarczonej partii towaru, a nie od wartości brutto przedmiotu całej umowy.**

- w § 6 ust. 1 lit. d) wnosimy o określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto **niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

3. Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 4 lit. f) z projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) *„Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.”* Powyższe zalecenia należy stosować w **każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POiŚ.** (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki *Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck*).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

4. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 6 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności. **UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: *„Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

5. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 7 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

#### Firma V

##### dotyczy Pakietu nr 11 Pozycja 14, 15, 16

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający na potwierdzenie zarejestrowania rękawic jako środka ochrony indywidualnej kategorii III typ B wymaga załączenia do oferty m.in. certyfikatu typu UE.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska, w pozycji 14, 15, 16 wymaga certyfikatu UE.

##### dotyczy Pakietu nr 11 Pozycja 1, 2, 3

W związku z tym, że dla środków ochrony osobistej kategorii I nie wystawia się certyfikatu badania typu UE, prosimy o dopuszczenie zamiennie deklaracji producenta.

Odpowiedź: W pozycji 1, 2, 3 Zamawiający nie wymaga certyfikatu UE.

#### Firma VI

**Pakiet 1, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 4** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 28x30cm o powierzchni klejącej 22x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 2-5** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 6** – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu prania wstępnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez pranie wstępnego.

**Pakiet 5, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści sterylny ręcznik włókninowy w rozmiarze 40x40cm pakowany a'1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30x40cm pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 7** - Czy Zamawiający ma na myśli ręczniki sterylne?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ręczniki sterylne.

**Pakiet 5, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 40x40cm pakowane a' 1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna dwukomorową w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 6, pozycja 1** – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby przypiec posiadał możliwość dzielenia bez użycia nożyczek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 6, pozycja 2 – 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a' 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 7** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 8, pozycja 1 – 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 11, poz. 6** – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli rękawice chirurgiczne, sterylne, pudrowane, co wynika z opisu przedmiotu zamówienia w sąsiednich pozycjach? Wskazujemy jednocześnie, że Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezpudrowych, rozmiar 7.0, w pozycji 17.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pakiet 11, poz. 14** – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których mediana siły zrywu przed starzeniem wynosi min. 7N?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 12, poz. 1-3** – Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, sterylne, nitrylowe, bezpudrowe, z poziomem AQL=1.5?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 12, poz. 1-3** – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, lekko pudrowane, mankiet rolowany, z rozróżnieniem na prawą i lewą rękę, pakowane parami w opakowanie 50par, miękkie i delikatne, a przy tym wytrzymałe i elastyczne, zgodne z EN455, AQL 1.0?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 13** – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, długości min. 290mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 20** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic równoważnych, diagnostycznych, nitrylowych, wewnątrznie chlorowanych, polimeryzowanych od strony roboczej, grubość na palcu  $0,08 \pm 0,01$ mm, mediana siły zrywu przed starzeniem 6,8N, przebadanych na odporność przed mikroorganizmami (bakterie i grzyby) według EN 374-2 oraz min 9 substancji chemicznych według EN 374-3, które to normy są równoważne dla EN374-5, rękawice pakowane a'250szt (S-L) oraz a'240szt (XL) w system pojedynczego wyjmowania rękawic za mankiet od spodu opakowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pakiet 17, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Serwety wzmocnionej osłony na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm,



łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

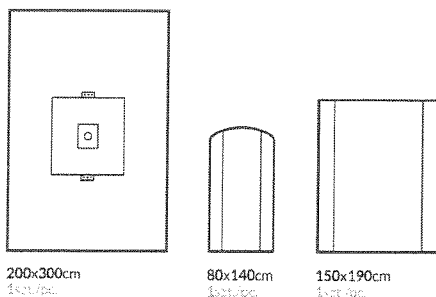

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

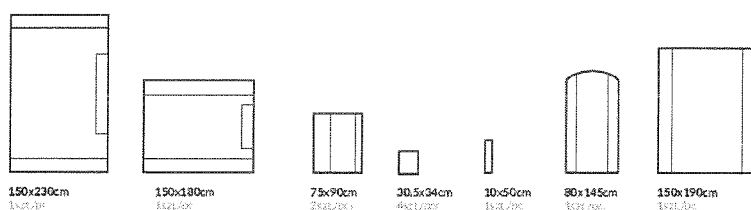

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, poz. 1, 6, 16, 17

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści tuffery pakowane a' 10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolną z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C w rozmiarze 100x220cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 70x180cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny 75cm x 50cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 14, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x180cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 150cm x 240cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym

1 x pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 20 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety 100% poliester,

2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, krój rękawów standardowy, pod szyją możliwość zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, kolorowa lamówka pod szyją ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha;

1 x czyszcik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG

1 x elektroda czynna monopolarna, 3 bolce zapakowana osobno, dołączona do opakowania zestawu

1 x ostrze do skalpela nr 24

3 x tupfer z gazy 30 x 30 cm, 17 nitok (tupfery umieszczone w misce nerkowatej)

1 x miska nerkowata 300 ml

1 x korcang plastikowy 23cm

1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym

1 x serweta 2-warstwowa przylepna min. 170 x 180 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym

2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym

1 x uchwyt rzepowy do kabli 2cm x 22cm

20 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

20 x kompres gazowy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x kieszeń przylepna PE 1-sekcyjna 40 x 30 cm

2 x chusta gazowa z RTG, 45 x 45 cm, 17 nitok ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 14, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. – serweta z włókniny 2-warstwowej polipropylenowo-polietylenowej 60 g/m<sup>2</sup>, Roz. 300cm x 230cm z elementem elastycznym i otworem 3,5cm

1 szt serweta na stół instrumentalny Roz. 190x 150 cm

1 szt. serweta Mayo 140cm x 80cm złożona teleskopowo warstwa chłonna Roz. 60cm x 140cm, folia niepiaskowana, grubość folii 50µm

1 szt. serweta foliowana 40 g/m<sup>2</sup> roz. 180cm x 150cm

1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny foliowanej 56 g/m<sup>2</sup> roz.. 80cm x 30cm

2 szt. taśmy medycznej 10cm x 50cm

4 szt. celulozowa serwetka chłonna 40cm x 40cm

Zestaw zapakowany w torebkę foliową ze wstawką Tyvek z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 15, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści tupfery 17 nitkowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 15, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści tupferty różki 12x12cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 15, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 15, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści kompresy składający się z włókninowej części zewnętrznej oraz wewnętrznej wykonanej z pulpy celulozowej lub włókninowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 15, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 55x75mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pakiet 15, poz. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy wysterylizowany w EO, gaza bielona metodą bezchlorkową, kg z podwijanymi brzegami, na opakowaniu etykieta przylepna w składzie:

- serweta gazowa ze znacznikiem rtg i tasiemką 20n 4 w 45 x 45 cm – 4 szt,
- kom. gaz. 17 n 16 w 10 x 10 cm – 2 x 10 szt kompresy z nitką rtg,
- kom. gaz. 17n 16w 7,5 x 7,5 cm – 2 x 10 szt kompresy z nitką rtg, ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do artroskopii kolana o składzie:

- 1 x serweta 2-warstwowa 150 x 260 na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości
- 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL; SMMMS PP min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny
- 1 x ostrze do skalpela nr 20
- 1 x osłona PE na kable kamery 14 x 250 cm, składana teleskopowo, z tekturową prowadnicą
- 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 30 x 80 cm cm rolowana
- 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm, 12 w 17 n
- 2 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm
- 1 x zatrask plastikowy do bezpiecznego usuwania ostrza ze skalpela
- 1 x serweta 2-warstwowa 230x320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, zintegrowana z torba do przechwytywania płynów z otworem samouszczelniającym, styszniakowe i portem do podłączenia drenów
- 10 x kompres gazowy 7,5cm x 7,5cm, 12 w 17 n

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta 2-warstwowa 150 x 260 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 2 – warstwowa 200 x 320 cm z otworem 25 x 30cm wypełnionym folia chirurgiczną oraz torba do zbiórki płynów 360 stopni
- 1 x ostrze do skalpela nr 24
- 1 x strzykawka Luer 50/60 ml
- 1 x kocyk dla noworodka z włókniny białej 70 x 80 cm
- 2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL; SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny, wzmacnienia min. 40 g/mkw
- 3 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30cm
- 3 x tupfer z gazy 40 x 30 cm, 20 nitek (tupfery umieszczone w misce 500 ml)
- 1 x miska okrągła 500 ml
- 1 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm
- 1 x opatrunek chłonny przylepny 25 x 10 cm
- 1 x igła iniekcyjna bezpieczna 1,2 x 40 mm
- 1 x pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 30 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy
- 50 x kompres gazowy ze znacznikiem RTG 10 x 10 cm, 16 w 17 n, wiązane a'10
- 6 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstw, 20 nitek, biała, po wstępnym praniu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do niedrożności jelit o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 260 x 150 na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całą długość

1 x pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 30 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min.35 g/mkw, mankiety z dzianiny

2 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL; SMS min. 35 g/mkw,

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XXL; , materiał podstawowy SMS min.35 g/mkw, mankiety z dzianiny

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przyklepny, kontrastujący w RTG

1 x elektroda czynna monopolarna, 3 bolce

1 x ostrze do skalpela nr 24

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 320 cm z otworem 25 x 30 cm wypełnionym folią, wzmacniona, bez worka

1 x worek 2-warstwowy rolowany 50 x 50 cm

1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm

20 x kompres z gazy z RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10 szt

40 x x kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10 szt

5 x tupfer z gazy 30 x 40 cm, 20 nitek (tupfery umieszczone po 3 szt w miskach nerkowatych)

1 x miska nerkowata 700 ml

1 x korcang plastikowy 23 cm

1 x uchwyt do ssaka zagięty 23CH długość około 26 cm

1 x dren do ssaka 300 cm CH24

1 x plastikowy pojemnik okrągły 1000 ml

6 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, biała, po wstępnym praniu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do żyłaków, jałowy wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min 55g/m<sup>2</sup>, o chłonności min. 450 %, sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu centralna etykieta z min. 2 nalepkami z numerem serii, data ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji.

Skład zestawu:

1.Serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm - 1 szt.

2.Serweta samoprzylepna 240 x 150 cm - 1 szt.

3.Serweta samoprzylepna, wzmacniona 200 x 260 cm z otworem wycięciem U o wymiarach 8,6 x 85 cm

4.Serweta nieprzylepna 150 x 210 cm - 1 szt.

5.Osłona na krocze 37 x 45cm – 1 szt.

6.Taśma przyklepna 10 x 50 cm - 1 szt.

7.Ręcznik celulozowy 40 x 40 cm - 4 szt.

8.Fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 40 g/m<sup>2</sup>, niezawierający celulozy i lateksu , rozm. L - 1 szt.

9.Fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 40 g/m<sup>2</sup>, niezawierający celulozy i lateksu , rozm. XL - 2szt.

10.Serweta gazowa, wstępnie prana, 4 warstwy 20 nitek z chipem RTG 45 x 45 cm (biała) - 4 szt.

11.Serweta na stół narzędziowy wzmacniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

12. Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm – 1 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do protezy biodra o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 150 x 260 na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta 2-warstwowa 190 x 150 na stół narzędziowy

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości

1 x pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 20 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety 100% poliester,

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety 100% poliester wzmocnienia min. 40 g/mkw

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL; materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety 100% poliester, wzmocnienia min. 40 g/mkw

1 x czyszcik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG

1 x elektroda czynna monopolarna, 3 bolce

1 x serweta wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem „U” 8,5cm x 85cm oraz ze zintegrowanym dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (papier zabezpieczający klej „U” minimum 3-częściowy

1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm

1 x strzykawka Żaneta 100 ml

1 x folia chirurgiczna 45 x 55 cm rozmiar powierzchni klejącej 45cm x 49cm

2 x ostrze do skalpela nr 24

1 x kieszeń przylepna PE 1-komorowa 43x 38 cm 40cm x 30cm

1 x osłona na kończyne 35 x 120 cm 2-warstwowa

1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22

4 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm

2 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm

1 x opaska elastyczna 12 cm x 5 m

80 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x miska nerkowata 300 ml

1 x uchwyt do ssaka zagięty 24CH 265 mm z V.C. końcówka w rozmiarze CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość około 26cm

1 x dren do ssaka 4 rozmiar CH 24 – 5,60mm/8,00mm (śr. wewn./śr. zewn.)

2 x dren Redona 18 CH 70 cm

2 x Butelka Redona do długotrwałego odsysania ran, o pojemności 400ml bez drenu

1 x pojemnik okrągły plastikowy bez uchwytu, poj. 1000 ml

4 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, biała, po wstępnym praniu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 19**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do protezy kolana o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 150 x 260 na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta 2-warstwowa 190 x 150 na stół narzędziowy

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości

1 x pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 20 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy  
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny  
3 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL; materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny, wzmacnienia min. 40 g/mkw  
1 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XXL; materiał podstawowy SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny, wzmacnienia min. 40 g/mkw  
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG  
1 x elektroda czynna monopolarna, 3 bolce  
1 x serweta 2-warstwowa 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 7cm umieszczonym centralnie, z dodatkowym padem chłonnym wokół otworu oraz zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli  
1 x strzykawka Żaneta 100 ml  
1 x folia chirurgiczna 30cm x 40cm (rozmiar powierzchni klejącej 30cm x 36cm)  
2 x ostrze do skalpela nr 24  
1 x kieszeń przylepna PE 1-komorowa 30cm x 40cm  
80 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10  
1 x miska nerkowata 300 ml  
1 x uchwyt do ssaka zagięty końcówka w rozmiarze CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość około 26cm  
1 x dren do ssaka rozmiar CH 24 - 5,60mm/8,00mm (śr. wewn./śr. zewn.)  
2 x dren Redona 18 CH 70cm  
2 x Butelka Redona do długotrwałego odsysania ran, o pojemności 400ml bez drenu  
1 x pojemnik okrągły plastikowy bez uchwytu, poj. 1000 ml  
4 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, biała, po wstępnym praniu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pakiet 15, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw uniwersalny o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 150 x 260cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)  
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo, rozmiar padu chłonnego 60cm x 85cm  
1 x pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 20 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy  
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny  
2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/mkw, mankiety z dzianiny  
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG  
1 x elektroda czynna monopolarna, 3 bolce  
1 x ostrze do skalpela nr 24  
3 x tupfer z gazy 40cm x 30cm, 2 17 nitek (tupfery umieszczone w misce nerkowatej)  
1 x miska nerkowata 300 ml  
1 x korcang plastikowy 23cm  
1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym  
1 x serweta 2-warstwowa przylepna 180cm x 180cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym  
2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym  
1 x uchwyt rzepowy do kabli 2cm x 22cm



20 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

20 x kompres gazowy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x kieszeń przylepna PE 1-sekcyjna 40cm x 30cm

2 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, biała, po wstępnym praniu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

#### **Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści zestawy zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe PP+PE, bez zawartości wiskozy i celulozy, min. 55 g/mkw i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych PP min. 110g/mkw i chłonności

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Firma VII**

Pakiet nr 11 poz. 14, 15, 16

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z poziomem szczelności AQL 1,5. Pakowane a'200 szt., z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

#### **Firma VIII**

### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **PAKIET NR 1**

##### **Pozycja 10**

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski z 2 zapinkami wewnątrz opakowania?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **PAKIET NR 5**

##### **Pozycja 6**

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych z dwiema etykietami (jedną na wewnętrznym opakowaniu, drugą na zewnętrznym opakowaniu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **PAKIET NR 6**

##### **Pozycja 1**

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca łatwo podzielonego z użyciem nożyczek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PAKIET NR 15**

##### **Pozycja 6**

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet z mim. 1 naklejką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pozycja 11**

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu zabiegowego z min. 2 naklejkami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pozycja 14, 19**

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z fartuchami polipropylenowymi (SMS)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pozycja 18, 20**

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z drenem do ssaka 20CH/24CH zamiast 24CH/30CH?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dotyczące projektu umowy**

- Prosimy o zmianę zapisów umowy na następujące:

**§ 6**

**KARY UMOWNE I Odstąpienie od umowy**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w wysokości 0,2% *wartości niezrealizowanego zamówienia* - za każdy rozpoczęty dzień *zwłoki* w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 3 Umowy;
  - b) w wysokości 0,2% *wartości niezrealizowanej części dostawy* - za każdy rozpoczęty dzień *zwłoki* w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;
  - c) w wysokości 0,2% *wartości wadliwej dostawy* - za każdy rozpoczęty dzień *zwłoki* w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;
  - d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% *wartości niezrealizowanej części umowy*.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

*mgr inż. Łukasz Węgrzyn*

.....  
Podpis Kierownika Jednostki Zamawiającego

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym.

1 x Strona internetowa Zamawiającego